

KRP

Prüfprotokoll

RX183-006-A

1/2

KUNDE:

FIBRO GMBH

BESTELLNUMMER:

8235012E25 FIBRO

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:

214510

ARTIKEL:

KRP1+R.17.4.XH

SERIENNR:

903918

ARTIKELNUMMER:

RX134735-41


REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX129592-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

903918

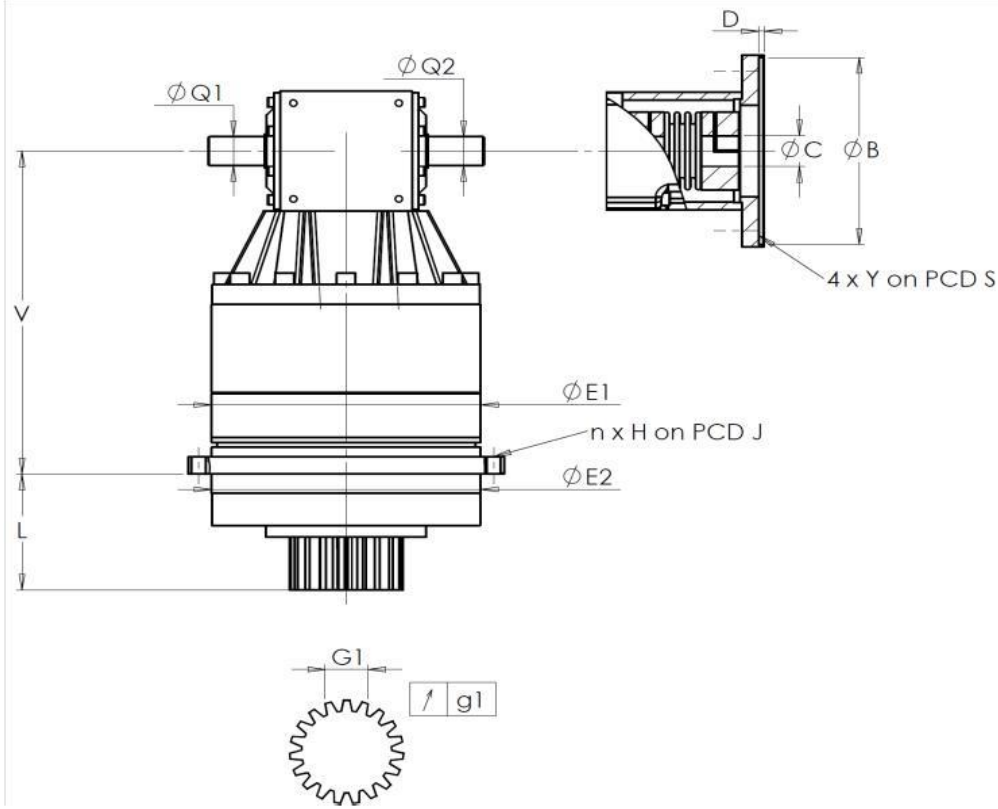

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE					ABTRIEBSRITZEL				MOTORFLANSCH									
Sollwert					Istwert				Sollwert				Istwert					
					C937								L2356					
									Zahnweite (über 3 Zähne)									
					E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,05	
					E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,99					Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03	
					n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK					Ø	D	5	Cr	5,09
					V	228,5	µm	228,28					Ø	S1	165	Cr	165	
					L	71	µm	70,73					Ø	Y1	M10	Pg	M10	
					Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20					Geräuschpegel				
					Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20					@1600 rpm Eintrieb (dB(A))				71,5
									Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1	81,39				
									Radiale Steifigkeit (N/µm)				1	369				

Datum:

13/11/2019

Von:

P VASLIER

Version:

A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr